


**Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека**

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)»
Нижнекамский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Татарстан (Татарстан)»
Испытательный лабораторный центр**

Юридический адрес: 420061, г. Казань, ул. Сеченова, 13а. Телефон, факс: 8(843) 221-90-03; e-mail: fguz@16rospotrebnadzor.ru ИНН/КПП 1660077474/166166001001
(почтовый индекс, юридический адрес, тел., факс., ИНН, КПП)
423570, РТ, г. Нижнекамск, ул. Ахтубинская, д. 18. Телефон, факс: 8(8555) 41-70-17, e-mail: nk_cgisen@mail.ru
ИНН/КПП 1660077474/165143001
ИНН/КПП 1660077474/165143001

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц:
РОСС RU.0001.510857
Дата внесения сведений в реестр: 29.06.2015

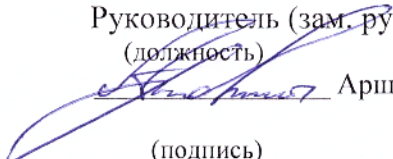

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель (зам. руководителя) ИЛЦ
(должность)
 Аршавский К. В.
(подпись) (ФИО)
«27» августа 2025 г.

ПРОТОКОЛ ИНСТРУМЕНТАЛЬНОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ

№ ф.17237.25 от «27» августа 2025 г.

Наименование и юридический адрес заказчика фактический адрес заказчика: МБУ ДО «Центр дополнительного образования для детей» НМР РТ, 423570, РТ, г. Нижнекамск, ул. Юности, д. 36Г.

Наименование и местоположение объекта: МБУ ДО «Центр дополнительного образования для детей» НМР РТ, 423570, РТ, г. Нижнекамск, ул. Юности, д. 36Г

Цель измерений: производственный контроль

Источники физических факторов и их характеристики: оргтехника

Дата и время проведения измерений: 27.08.2025г., с 13 час.00 мин

НД на методы выполнения измерений: МУК 4.3.2491-09 «Гигиеническая оценка электрических и магнитных полей промышленной частоты (50 Гц) в производственных условиях».

Сведения о средствах измерения:

Наименование средства измерения, заводской номер	Инвентарный номер, год ввода в эксплуатацию	Сведения о государственной поверке	Действителен до
Измеритель напряженности поля промышленной частоты ПЗ-50	№ 00000000013 0, 2004	№ С -БН /26-05-2022/66/268788 пределы допускаемой относительной основной погрешности измерения напряженности электрического поля:	До 25.05.2026

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец.

Протокол не может быть частично или полностью воспроизведен без разрешения ИЛЦ.

Протокол от 27 августа 2025 г. № ф.17237.25

		$\pm[15+0,2[Eп/Eх]]$, %, где Еп-предел измерения, Ех - измеренное значение, кВ/м; пределы допускаемой относительной основной погрешности измерения напряженности магнитного поля: $\pm[15+0,2[Нп/Нх]]$, %, где Нп-предел измерения, Нх - измеренное значение, А/м	
Прибор для контроля параметров воздушной среды (с измерительным щупом Щ-1) Метеометр МЭС 200А № 1976	Инв №000000000 1631 2007 год	№ 389119576 от 21.11.2024 г. Основная абсолютная погрешность температуры +/- 0,2°С, влажности +/- 3,0%, скорости движения воздуха в диапазоне 0,1-1,0 м/с +/- (0,05+0,05Vх) м/с, при скорости движения в диапазоне 1,0-20 м/с +/- (0,5+0,05V) м/с	20.11.2025г.
Рулетка измерительная металлическая Р20У2К №0018	№ ЧА380461. 2021год	№ 434576042 от 20.05.2025г.	19.05.2026 г..


Условия проведения измерений: t +23,0°С, +23,1°С, влажность 42%, атмосферное давление 99 кПа.

Метеорологические условия: +25° С.

Измерения проводились в присутствии:

Эскиз помещения (территории, рабочего места) или описание расположения точек измерения:

См. результаты измерений

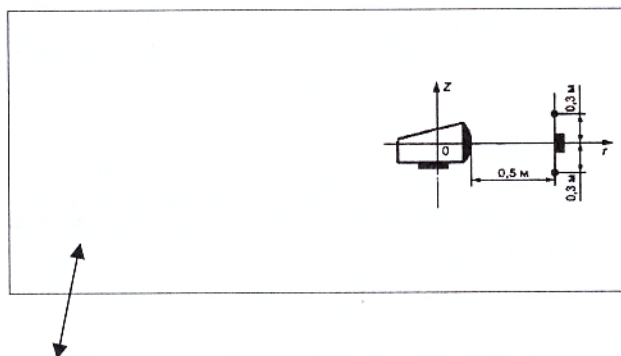

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец.

Протокол не может быть частично или полностью воспроизведен без разрешения ИЛЦ.

Протокол от 27 августа 2025 г. № ф.17237.25

№ п/п	Место проведения измерения	Расстояние до источника, м	Напряженность электрического поля промышленной частоты, кВ/м, с учетом неопределенности*	Напряженность магнитного поля промышленной частоты, А/м, с учетом неопределенности*	Напряженность электростатического поля, кВ/м, с учетом неопределенности*
1	2	3	4	5	6
1.	Учебный класс «ЮИД» рабочее место с ПЭВМ монитор h=0,5/1,0/1,5м от пола	0,5	<0,01 <0,01 <0,01	<0,1 <0,1 <0,1	
2.	Кабинет №1 рабочее место с ПЭВМ монитор h=0,5/1,0/1,5м от пола	0,5	<0,01 <0,01 <0,01	<0,1 <0,1 <0,1	
3.	Методический кабинет, рабочее место заведующего отделом методической работой рабочее место с ПЭВМ монитор h=0,5/1,0/1,5м от пола	0,5	<0,01 <0,01 <0,01	<0,1 <0,1 <0,1	
	ПДУ		5 кВ/м	80 А/м	

Мнение и интерпретация: *

Дополнительные сведения: *

Нормативный документ, устанавливающий требования СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

3 Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец.

Протокол не может быть частично или полностью воспроизведен без разрешения ИЛЦ.

Протокол от 27 августа 2025 г. № ф.17237.25

Ответственный за проведение измерений:

Эксперт-физик по контролю за источниками
ионизирующих и неионизирующих излучений
(должность)

Пушканова Н.М.
(ФИО)

(подпись)

27.08.2025 г.
(дата)

Конец протокола от 27 августа 2025г. № ф.17237.25

3 Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец.

Протокол не может быть частично или полностью воспроизведен без разрешения ИЛЦ.
Протокол от 27 августа 2025 г. № ф.17237.25